

④

# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

申请科室: 内二

2018年5月17日

设备名称	<u>心电图机</u>	购进日期	<u>2010.5.20</u>
设备型号	<u>MEC-1000</u>	购进价格	<u>25,000.~</u>
序列号	<u>AQ-20136202</u>	填报人	<u>王博</u>

报废原因:

心电图机屏, 到维修组维修, 已不能正常运行和使用



使用科室主管院长意见:

王博 2018年5月18日

设备科意见:

设备使用年限太长, 修复成本较高, 建议报废

同意


韩俊 2018年5月21日

设备科主管院长意见:

王博 2018年5月18日

备注:

设备名称	心电监护	设备型号	MEC-1000
------	------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备使用年限长，维修成本高，建议报废

该设备已停产，无配件维修

该设备使用年限长，高压模块损坏，根据厂家提供的资料显示：  
MEC-1000、MEC-2000 整机配件已于2016年7月停产，无法提供。

签字：

吴章苗  
韩斌  
潘政

②



✓ A13015

# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

申请科室: 内四

2018年9月13日


设备名称	心电监护仪	购进日期	2008.1.3
设备型号	MEC-1000	购进价格	25000.00
序列号	AA-7C106752	填报人	原小波
报废原因:		无法修理.	
使用科室意见:		该设备故障为电源模块损坏, 考虑到维修成本及维修价值, 且已达到使用年限, 建议报废	
设备科意见:		2018年10月8日	
使用科室分管院长意见:		2018年10月8日	
设备科分管院长意见:		2018年10月8日	



(Signature) 2018 10 8

(Signature) 2018 10 8

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，无法修复，建议报废。

该设备使用年限长，血压模块损坏，根据厂家提供的资料显示：  
MEC-1000、MEC-2000 整机配件已于2016年8月停产，无法提供。

签

字：

韦荣海-清州  
吴章林-清州






3

B0819


# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

申请科室: 肾内科

2018 年 11 月 8 日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2009.7
设备型号	MeL-1000	购进价格	2.87万元
序列号	AQ-86114125	填报人	陈年
报废原因: <div style="text-align: right;">             科室负责人签字:  </div>			
使用科室主管院长意见: <div style="text-align: right;">             2018年 12月 6日         </div>			
设备科意见: <div style="text-align: center;">  </div> <p>设备使用近十年, 现已损坏主要核心配件, 维修成本较高          建议报废.</p> <div style="text-align: right;">  年 月 日         </div>			
设备科主管院长意见: <div style="text-align: right;">           :            年 月 日         </div>			
备注:			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------




设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，无法修复，建议报废。  
 该设备使用年限长，血压模块坏，根据厂家提供的资料显示：MEC-1000、  
 MEC-2000 整机及配件已于2016年8月停产，无法提供。

签 字： 韩俊涛  
 吴章赫



设备名称	尿道膀胱镜	设备型号	PG-VA
------	-------	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，无法修复，建议报废。  
 该设备已损坏，因使用频率高，元器件老化，维修成本高，参照医院国有资产  
 报废年限标准，该设备已达报废年限。

签

字：

陈俊  
 吴章

# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

⑤

申请科室 内二

2018年12月13日

设备名称	微量注射泵(双道)	购进日期	2008年
设备型号	W2-50C6	购进价格	6000.00
序列号		填报人	王梅

报废原因:

该设备使用年限长,无法正常运行。

签字: 王梅

使用科室意见:

同意报废

18年12月13日




使用科室分管院长意见:

王梅

年 月 日

设备科意见:




年 月 日

设备科分管院长意见:

王梅

年 月 日

设备名称	输液泵	设备型号	WZS-50F6
------	-----	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：





该设备使用年限长，维修成本高，建议报废  
 该设备使用年限长，元器件老化且已超过厂家设计使用寿命。根据史密斯仪器有限公司提供的WZ系列微量注射泵安全使用年限，该设备已超出使用年限3年。

签字： 韩俊 孙昊 汤正斌

# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

申请科室 内二

2018年12月13日

设备名称	心电图监护仪	购进日期	2011.3.17
设备型号	MEC-1000	购进价格	25000元
序列号	AQ-0A145101	填报人	王梅
报废原因: 该设备使用年限长,无法正常运行 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">签字: 王梅 张华</div>			
使用科室意见: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意报废</p> <p>张华</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
使用科室分管院长意见: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       年 月 日                 </div>			
设备科意见: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       年 月 日                 </div>			
设备科分管院长意见: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       年 月 日                 </div>			

设备名称	心电监护	设备型号	MEC-1000
------	------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备使用年限长，~~维修成本高~~，建议报废  
 血压模块损坏。根据厂家提供的资料显示：MEC-1000  
 MEC-2000 整机配件已于2016年8月停产，无法提供

签字： 韩俊 潘正斌



A12150

70


# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

申请科室：口腔科

2018年12月23日

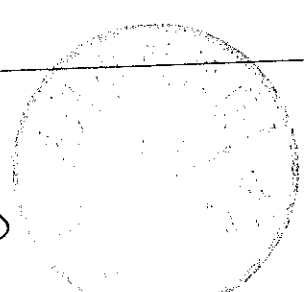设备名称	牙科综合治疗机	购进日期	2014
设备型号	ST-D307	购进价格	108,000.5
序列号	3071406038	填报人	
报废原因： 无维修价值	多次维修，无法正常使用		签字：[Signature]
使用科室意见：	情况属实		2018年12月23日
设备科意见：		李法乾	2018年4月1日
使用科室分管院长意见：		[Signature]	2018年1月4日
设备科分管院长意见：		[Signature]	年 月 日

设备名称	口腔科综合治疗椅	设备型号	KLT6220-N6
------	----------	------	------------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备经多次维修均还存在故障，维修成本高，建议报废！

签

字：

吴章伟  
陈俊涛

2022.10.27

# 黔南州中医医院医疗器械报废申请表


2019年3月26日

申请科室：制剂科

设备名称	多功能提取机	购进日期	2006-08-15
设备型号	BTV-30	购进价格	427000.00
序列号	1200056	填报人	唐毅


报废原因：

因不能满足现在生产所需，特此申请报废。

签字：

使用科室意见：

申请报废



2019年3月27日


设备科意见：

同意


唐毅

2019年4月1日

使用科室分管院长意见：


 2019年4月1日

设备科分管院长意见：



年 月 日

设备名称	多功能提取机	设备型号	BTV-30
------	--------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备内部电路烧毁，维修成本高，建议报废！

签

字：


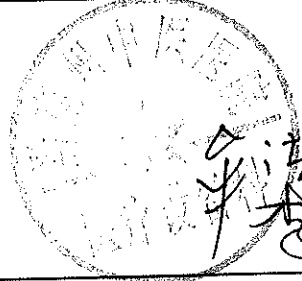
吴章伟  
韩俊涛




# 黔南州中医医院医疗器械报废申请表

申请科室：制剂科 微波真空干燥箱

2019年3月26日

设备名称	电热恒温干燥箱	购进日期	2013.5.21
设备型号	101-3AB	购进价格	109.700
序列号	无	填报人	唐毅
报废原因： <p style="text-align: center;">烧毁不能正常使用，特此申请报废。</p> <p style="text-align: right;">签字：唐毅</p>			
使用科室意见： <p style="text-align: center;">申请报废</p>  <p style="text-align: right;">2019年3月27日</p>			
设备科意见： <p style="text-align: center;">同意</p>  <p style="text-align: right;">2019年4月1日</p>			
使用科室分管院长意见： <p style="text-align: right;">2019年4月1日</p>			
设备科分管院长意见： <p style="text-align: right;">唐毅</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

设备名称	制剂科电热恒温箱	设备型号	202-3
------	----------	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备内部电路烧毁，维修成本高，建议报废！


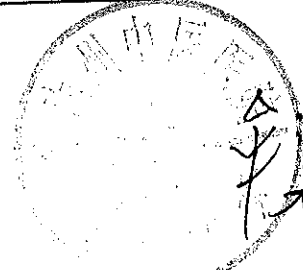


签字：吴章林  
魏敏 潘斌

114185  
(10)

# 黔南州中医医院医疗器械报废申请表

申请科室：制剂科

2019年3月26日

设备名称	电热鼓风干燥箱	购进日期	2016.2.15
设备型号	101-4	购进价格	18,000.5
序列号	DHG-9640A	填报人	唐毅
报废原因： 烧毁不能正常使用，特此申请报废。 签字：唐毅			
使用科室意见：  2019年3月27日			
设备科意见：  2019年4月1日			
使用科室分管院长意见：  2019年4月1日			
设备科分管院长意见：  年 月 日			

设备名称	制剂科电热鼓风干燥箱	设备型号	101-4
------	------------	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备内部电路烧毁，维修成本高，建议报废！

签

字：

吴翰林  
魏东 潘成



A13038



# 黔南州中医医院医疗器械报废申请表

申请科室：制剂科

2019年3月26日

设备名称	搅拌夹层锅	购进日期	2012-12-2
设备型号	-- 无	购进价格	13000.00
序列号	-- 无	填报人	唐毅
报废原因： <p style="text-align: center;">因不能满足现在生产所需，特此申请报废。</p> <p style="text-align: right;">签字：唐毅</p>			
使用科室意见： <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 2em; margin: 0;">申请报废</p> </div> <p style="text-align: right;">2019年3月27日</p>			
设备科意见： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">同意</div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 2em;">李健</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">2019年4月1日</p>			
使用科室分管院长意见： <p style="text-align: right;">2019年4月1日</p>			
设备科分管院长意见： <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

设备名称	制剂科搅拌夹层锅	设备型号	
------	----------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：

该设备内部电路烧毁，维修成本高，建议报废！

签字：李章林 李章林





B0824  
12

B0824


# 黔南州中医医院医疗器械报废申请表

申请科室：制剂科

2019年3月26日 2012.4.30

设备名称	粉碎机	购进日期	2014-11-11
设备型号	B20	购进价格	35000.00 12500
序列号	201408229	填报人	唐毅
<p>报废原因：</p> <p>粉碎齿头全部断裂，不能正常使用，特此申请报废。</p> <p style="text-align: right;">签字：唐毅</p>			
<p>使用科室意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>2019年3月27日</p> </div>			
<p>设备科意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>同意</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>李洪波</p> <p>李洪波</p> <p>2019年4月1日</p> </div> </div>			
<p>使用科室分管院长意见：</p> <div style="text-align: right;">  <p>2019年4月1日</p> </div>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <div style="text-align: right;">  <p>年 月 日</p> </div>			

设备名称	制剂科粉碎机	设备型号	B20
------	--------	------	-----



设备维修（护）技术人员意见：

该设备内部电路烧毁，维修成本高，建议报废！

签字：吴章书 潘研




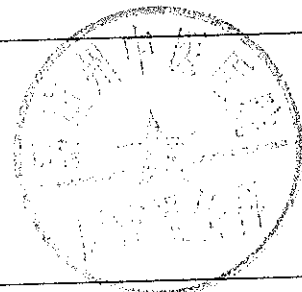



13-18 9

# 黔南州中医院医疗器械报废申请表


B0807

申请科室：脑病外科

2019年4月15日

设备名称	心电监护	购进日期	2008
设备型号	MEC-1000	购进价格	58000.-
序列号	AD-3312338/ AQ-1108385	填报人	冯涛
报废原因： 因使用年限过长，心电监护仪出现黑屏情况，无法修复，特申请报废。  签字：冯涛			
使用科室意见：  			
设备科意见：   			
使用科室分管院长意见：  <p>2019年4月15日</p>			
设备科分管院长意见：  <p>年 月 日</p>			

设备名称	脑病外科	设备型号	MEC-1000
------	------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备达到使用年限，已损坏，维修成本过高，建议报废！

高压模块

根据厂家提供的资料显示

MEC-1000、MEC-2000 整体西研研于2016  
年已停产，无法提供。

签字：

吴章林  
陈俊、潘明

A1102  
15.

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：消毒供应室

2019年5月10日

设备名称	脉动真空 灭菌器	购进日期	2011.2
设备型号	DMB-1.2	购进价格	288000元
序列号	20102291	填报人	邵云

报废原因：超过使用年限，设备技术指标无法达到生产工艺要求，有安全隐患。

科室负责人签字：邵云

2019年5月10日

设备管理科室意见：

科室负责人签字：

2019年5月11日

财务科意见：

科室负责人签字：

2019年5月11日

职能管理科室分管领导意见：

签字：

2019年6月17日

总会计师意见：


分管院长意见：

签字：

年月日

备注：

设备名称	脉动真空灭菌器	设备型号	DMB-1.2
------	---------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已达到使用年限，按照压力容器管理  
相关规定强制报废。

签






字：

吴章林  
韩俊 潘斌

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：急诊医学科

2019年06月06日

设备名称	手摇三折床	购进日期	2006.08
设备型号	3130	购进价格	4160
序列号	B157	填报人	张运良
报废原因：使用时间长，不能正常使用，维修组看过不能维修。 科室负责人签字：  2019年6月6日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年4月20日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年月日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年月日			
院长意见： 签字：  年月日			

设备名称	手摇三折床	设备型号	3130
------	-------	------	------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备使用年限长，部件老化  
~~该设备已损坏，无法修复，~~建议报废。

签

字：


韩的 刘  
吴 章 书

A12182  
1A

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肛肠科

2019年6月17日

设备名称	中国产呼吸机	购进日期	2012.7.12
设备型号	X4-X	购进价格	30,000.5
序列号	X4X21207106	填报人	邓公
<p>报废原因：该材料因同型号呼吸机使用年限，已无法修理，故申请报废。</p> <p>科室负责人签字：符春平 2019年6月17日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> 		<p>科室负责人签字：李法强 2019年7月3日</p>	
<p>财务科意见：</p>		<p>科室负责人签字：罗兰 2019年7月9日</p>	
<p>职能管理科室分管领导意见：</p>		<p>签字：李 年 月 日</p>	
<p>总会计师意见： 财务分管院长</p>		<p>签字：李 年 月 日</p>	
<p>备注：</p>			

设备名称	多功能熏蒸仪	设备型号	XH-X
------	--------	------	------



设备维修（护）技术人员意见：  
 该设备~~使用年限~~维修成本高，建议  
 报废  
 已损坏故障为主板故障，且已送到  
 通用设计使  
 用寿命！


签 字：  
 韩俊 吴章书

ADK  
8


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肛肠科

2019年6月17日

设备名称	序同多... 序同多... 序同多...	购进日期	2012.7.12
设备型号	XN-X	购进价格	30,000.00
序列号	XNXC1206090	填报人	李... 李...
报废原因：中物科... 科室负责人签字：李... 2019年6月17日			
设备管理科室意见：  科室负责人签字：李... 2019年7月3日			
财务科意见： 科室负责人签字：李... 2019年7月9日			
职能管理科室分管领导意见： 签字：李... 年 月 日			
总会计师意见： 对...分管院长 签字：李... 年 月 日			
备注：			

设备名称	多功能熏蒸仪	设备型号	XH-X
------	--------	------	------



设备维修（护）技术人员意见：  
 该设备体用年限久，维修成本高，建议报废。  
 已损坏故障为到的故障。

签字：  
 魏俊英

# 黔南州中医院医疗器械报废申请表

79

2019

申请科室:



心电监护

2019 年 6 月 19 日

设备名称	心电监护	购进日期	2009-1 <del>AQ-83110209</del>
设备型号	MEC-1000	购进价格	<del>2009</del> T
序列号	AQ-83110209	填报人	张涛

报废原因:

因使用年限过长. 线路及零配件老化.  
特申请报废.

签字: 张涛.


使用科室意见:

同意

*[Signature]*

2019 年 6 月 19 日

设备科意见:



年 月 日

使用科室分管院长意见:


同意

*[Signature]*  
2019 年 6 月 19 日

设备科分管院长意见:

年 月 日

设备名称	脑病外科	设备型号	MEC-1000
------	------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，高压模块损坏，根据厂家提供的资料显示 MEC-1000、MEC-2000 整机配件已于2016年8月停产，该设备达到使用年限，已损坏，维修成本过高，建议报废！

签字：

李荣俊 潘明  
李荣俊 潘明

A15016  
20

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：消毒供应室

2019年8月20日

设备名称	医用器械 干燥柜	购进日期	2013.5
设备型号	LK/GZG-500L	购进价格	96000元
序列号	13061102 3008	填报人	

报废原因：超过使用年限，设备技术指标无法达到生产工艺要求，有安全隐患。

科室负责人签字：[Signature]  
2019年8月20日

设备管理科室意见：

[Signature]

科室负责人签字：[Signature]  
2019年9月1日

财务科意见：

[Signature]  
科室负责人签字：[Signature]  
2019年9月9日

职能管理科室分管领导意见：


签字：[Signature]  
2019年7月11日

总会计师意见：  
分管院长意见：

[Signature]  
签字：  
2019年9月23日

备注：

设备名称	脉动真空灭菌器	设备型号	LK/GZG-500L
------	---------	------	-------------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已达到使用年限，建议报废。

~~不能达到技术要求。~~

该设备属于损耗设备，电气部分不能通过改造达到新的技术指标要求。

签字：

曹荣俊 吴章林 张晓明

1134  
21

114062

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：消毒供应室

2019年8月20日

设备名称	医用器械 干燥柜	购进日期	2013.8
设备型号	LK/GZG-500L	购进价格	96000元
序列号	13061102 3005	填报人	

报废原因：达到使用年限，设备技术指标无法达到生产工艺要求，有安全隐患。

科室负责人签字：[Signature]  
2019年8月20日

设备管理科室意见：

[Signature]

科室负责人签字：[Signature]  
2019年9月1日

财务科意见：

[Signature]  
科室负责人签字：[Signature]  
2019年9月9日

职能管理科室分管领导意见：

签字：[Signature]  
2019年9月11日

总会计师意见：  
分管副院长意见

[Signature] 签字：[Signature]  
2019年9月23日

备注：

设备名称	脉动真空灭菌器	设备型号	LK/GZG-500L
------	---------	------	-------------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已达到使用年限，建议报废。

不能达到技术要求，  
该设备属于损耗设备，电气部分不能通过改造达到新的技术指标要求。

签 字： 杨敏 姜学书 孙海明




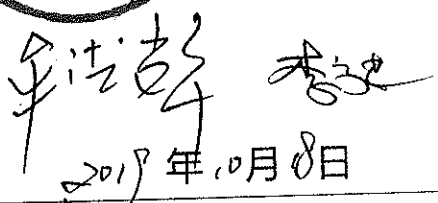




23

A130751 A130761 A130777 / A13078

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：心内科 (内三)

2019年8月22日


设备名称	病人记录器 (4个)	购进日期	2013.11
设备型号	DMS300	购进价格	25000/台
序列号	04671、05016、05025、 05100	填报人	
报废原因：损坏后无法进行维修。 科室负责人签字：  2019年10月11日			
设备管理科室意见：	同意   科室负责人签字：  2019年10月8日		
财务科意见：	同意  科室负责人签字：  2019年10月28日		
设备科分管院长意见：	签字：  年 月 日		
财务科分管院长意见：	签字：  2019年11月21日		

设备名称	<del>脑电图</del>	设备型号	<del>                    </del>
------	----------------	------	---------------------------------

设备名称	病人记录器 (4个)	购进日期	2013.09
设备型号	DMS300	购进价格	25000
序列号	04671、05016、05025、05100	填报人	

报废原因：损坏后无法进行维修。

科室负责人签

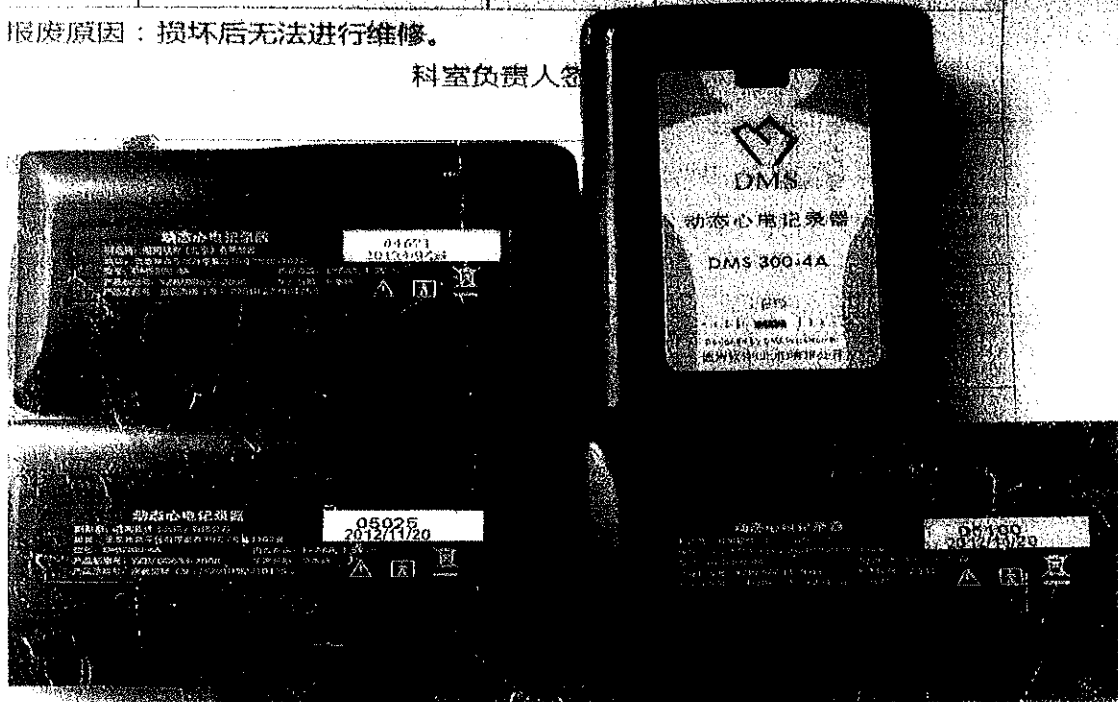

设备维修（护）技术人员意见：

易碎。封装类设备

该设备达到使用年限，~~长~~已损坏，维修成本过高，建议报废！

签

字：



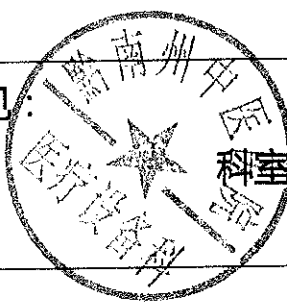
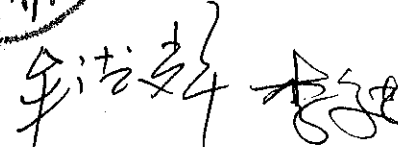




魏志 孙静 姜明

28


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：1094

2019年9月9日

设备名称	老肯牌KDSJ-Y100型经济毒机	购进日期	2013.04.22.
设备型号	KDSJ-Y100 LK1CXD	购进价格	13,800.-
序列号	<del>11206030020</del> 130407020002	填报人	高志香
报废原因：设备坏，维修费用较高并已达使用年限。 科室负责人签字：  2019年9月9日			
设备管理科室意见：   科室负责人签字：  2019年9月17日			
财务科意见：  科室负责人签字：  2019年9月17日			
设备科分管院长意见： 签字：  2019年9月18日			
财务科分管院长意见： 签字：  2019年9月23日			
备注：			

设备名称	空气消毒机箱	设备型号	KDSJ-Y100
------	--------	------	-----------



设备维修（护）技术人员意见：

~~该设备使用年限长，已不能达到相关技术指标要求，且维修价值不高，建议报废。~~

该设备主板已损坏，维修成本高，建议报废。

签 字：

韩俊  
吴章书









# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

24


B0935

2019年9月9日

申请科室：儿科

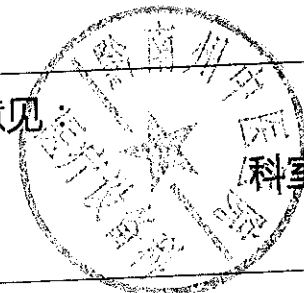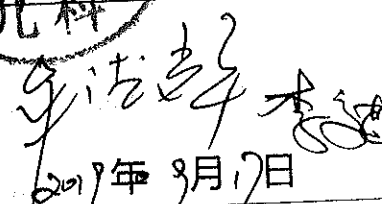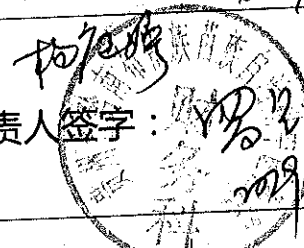设备名称	婴儿培养箱	购进日期	2009.7.15
设备型号	Yp-100A	购进价格	26000
序列号	02090302029	填报人	高静
报废原因：设备已达到使用年限，申请报废 科室负责人签字：  2019年09月09日 			
设备管理科室意见： 同意  科室负责人签字：  2019年9月17日			
财务科意见： 同意  科室负责人签字：  2019年9月17日			
设备科分管院长意见： 签字：  2019年09月18日			
财务科分管院长意见： 签字：  2019年9月23日			
备注：			

设备名称	婴儿培养箱	设备型号	YP-100A
------	-------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：已使用10年..

该设备使用年限长，已不能达到相关技术指标要求，且维修价值不高，建议报废。

签 字：

姜子书

韩俊 书





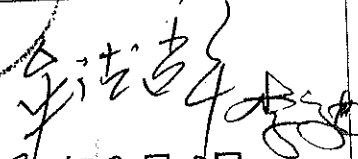





28

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


20944

2019年9月9日

申请科室：儿科

设备名称	婴儿培养箱	购进日期	2009.11.23
设备型号	Yp-100A	购进价格	26,000-
序列号	0209 0201015	填报人	高志秀
报废原因：设备已达到使用年限，申请报废 科室负责人签字：  2019年9月9日 			
设备管理科室意见：   科室负责人签字：  2019年9月17日 儿科			
财务科意见：  科室负责人签字：  2019年9月17日 			
设备科分管院长意见： 签字：  2019年9月18日			
财务科分管院长意见： 签字：  2019年9月23日			
备注：			

设备名称	婴儿培养箱	设备型号	YP-100A
------	-------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：*已使用10年。*

该设备使用年限长，已不能达到相关技术指标要求，且维修价值不高，建议报废。

签 字：

*韩俊*  
*吴书*


B16009


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


申请科室：儿科 2019年9月9日


设备名称	婴幼儿氧舱	购进日期	2013.12.19
设备型号	YLCD.5-1.5	购进价格	105,000
序列号	1303-1.5(02)	填报人	高


报废原因：特种设备已达到使用年限，强制报废


科室负责人签字：  2019年09月09日


设备管理科室意见：  同意

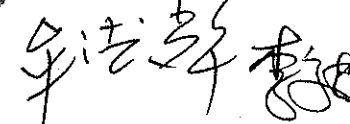
科室负责人签字：  2019年09月07日


财务科意见：  同意

科室负责人签字：  2019年9月17日

设备科分管院长意见：  同意


签字：  2019年09月18日

财务科分管院长意见：  同意

签字：  2019年9月18日

备注：送医院办公室

设备名称	婴儿氧箱	设备型号	YLC0.5/1.5
------	------	------	------------



设备维修（护）技术人员意见：已于2019年12月强制停止使用。  
该设备已达到使用年限，属于特种设备，强制报废。

签字： 韩俊 韩  
吴章书










47

B0728


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：脑病内科、糖尿病专科(内-)

2019年09月27日

设备名称	心电监护	购进日期	2007年
设备型号	MEC-1000	购进价格	29000.
序列号	AQ-7A105143	填报人	周新明
<p>报废原因：该设备经设备科检查，故障为显示屏高压模块损坏，该设备使用年限过长，维修成本高，设备科建议报废。</p> <p>科室负责人签字：     2019年9月27日</p>			
<p>设备管理科室意见：    科室负责人签字：   李法波  2019年10月1日</p>			
<p>财务科意见：   科室负责人签字：    2019年10月18日</p>			
<p>设备科分管院长意见：  签字：    年 月 日</p>			
<p>财务科分管院长意见：  签字：    2019年11月11日</p>			
<p>备注：</p>			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备整机配件已于2016年7月停产。

该设备达到报废使用年限，设备科维修组检查后确认故障为显示屏高压模块损坏，维修成本高，建议报废。




签字： 魏俊 姜学林 潘成

28

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：脑病外科

2019年09月25日

设备名称	心电监护	购进日期	2008年
设备型号	MEC-1000	购进价格	29000
序列号	AQ-83110249	填报人	张强
报废原因：该设备经设备科检查，故障为显示屏高压模块损坏，该设备使用年限过长，维修成本高。 科室负责人签字：张强  2019年9月25日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：张强  2020年6月5日			
财务科意见：同意，按流程办理。 科室负责人签字：潘兰  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李强 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李强 年 月 日			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备整机配件已于2016年10月停产。

该设备已损坏，故障为显示屏高压模块损坏，该设备使用年限长，维修成本风险高，建议报废。

签

字：

李葆收-清  
吴林-新

A13086

38

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肝胆外科、心胸外科 (外二科)

2019年10月9日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2013.07
设备型号	G30	购进价格	38900.
序列号	CN12808029	填报人	田伟


报废原因：该设备达到报废使用年限，部分功能已不能使用，维修成本高，设备科维修组检查后建议报废。

科室负责人签字：田伟

2019年10月9日

设备管理科室意见：

同意



科室负责人签字：李洪波

2019年10月11日

财务科意见：

科室负责人签字：田伟

2019年10月28日

设备科分管院长意见：

签字：田伟

年 月 日


财务科分管院长意见：

签字：田伟

2019年10月25日

备注：

设备名称	心电监护仪	设备型号	<del>PHILIPS</del> Q30
------	-------	------	------------------------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备达到报废使用年限，部分功能已不能使用，维修成本高，设备科维修组检查后建议报废。

签字： *赖俊英* 2017.12.27

011501. A1226  
设备科. 607

B1010

29

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


申请科室：肝胆外科、心胸外科 (外科)

2019年10月9日


设备名称	心电监护仪	购进日期	2009.08
设备型号	UT4000B	购进价格	35000.
序列号	CN4BAAJQ00440	填报人	周伟

报废原因：该设备使用年限长，部分功能已不能使用，维修成本高，设备科维修组检查后建议报废。


科室负责人签字：

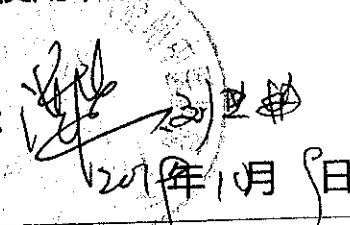  
2019年10月9日

设备管理科室意见：

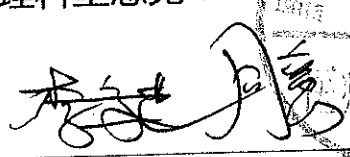


科室负责人签字：

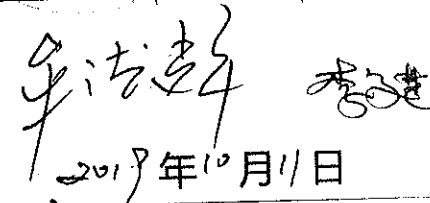  
2019年10月11日


财务科意见：

科室负责人签字：

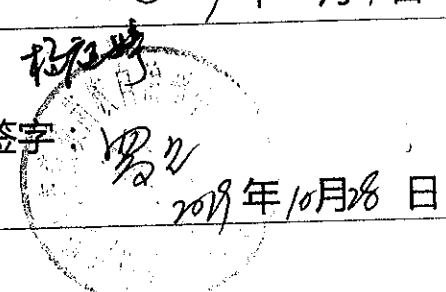  
2019年10月28日


设备科分管院长意见：

签字：

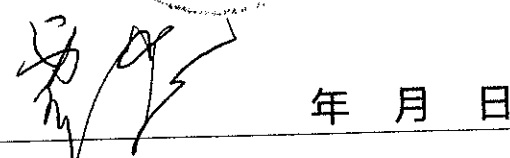  
年 月 日


财务科分管院长意见：

签字：

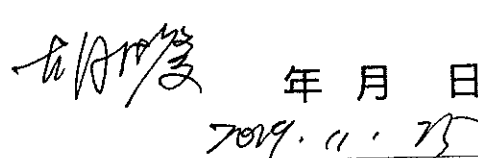  
年 月 日  
2019.11.15

备注：

设备名称	心电监护仪	设备型号	UT4000B
------	-------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备达到报废使用年限，部分功能已不能使用，维修成本高，设备科维修组检查后建议报废。

签字： 魏文英 姜子中 姜正华

A12191

30

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：国医堂（中医门诊）

2019年10月29日

设备名称	精子分析仪系统	购进日期	2012.9
设备型号	WLJY-9000	购进价格	92000.00
序列号	J0712100105C	填报人	杨吕路


报废原因：该设备达到报废使用年限，部分功能已不能使用，维修成本高，设备科维修组检查后建议报废。


科室负责人签字：




2019年10月30日

设备管理科室意见：





科室负责人签字：





2020年1月7日

财务科意见：

按相关规定执行

科室负责人签字：



2020年3月2日

设备科分管院长意见：




签字：



2020年3月4日

财务科分管院长意见：


签字：



2020.3.2

备注：

设备名称	精子分析仪	设备型号	WLJY-9000
------	-------	------	-----------



设备维修（护）技术人员意见：

厂家建议更换主板

该设备反复故障，<sup>主板</sup>维修成本高，建议报废。

签

字：

韩 新 韩 俊  
清 正







2012  
12  
26

31


01113

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

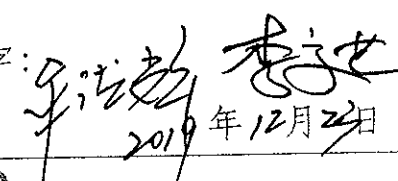申请科室： 麻醉科手术室 2019年11月5日

设备名称	医用电脑高频电刀(双极)	购进日期	<del>2008年</del> 2012年5月
设备型号	DGD-300B-2	购进价格	22,000.5
序列号	81150550 元	填报人	
<p>报废原因：该设备达到并超过报废使用年限，无法购买配件维修，设备科维修组检查后建议报废。</p> <p>科室负责人签字： 2019年11月5日</p>			
<p>设备管理科室意见： 同意</p> <p>科室负责人签字： 2019年12月24日</p>			
<p>财务科意见： 报相关规范执行。</p> <p>科室负责人签字： 2020年3月2日</p>			
<p>设备科分管院长意见： </p> <p>签字： 2019年 月 日</p>			
<p>财务科分管院长意见： 签字： 2020.3.23 年 月 日</p>			
备注：			

设备名称	高频电刀	设备型号	DGD-300B-2
------	------	------	------------



设备维修（护）技术人员意见：设备使用说明书标注使用寿命4年。

该设备已达报废年限，维修成本高，建议报废！

签字：杨俊英 李洪海  
张

2014.11.11

2020

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉科手术室

2019年11月5日

设备名称	WaveLight 钬激光 (钬激光等离子电切)	购进日期	2009年
设备型号	3020-1-065	购进价格	1,180,000.00
序列号	3020-1-065 无	填报人	

报废原因：该设备达到并超过报废使用年限，无法购买配件维修，设备科维修组检查后建议报废。


科室负责人签字：

  
2019年11月5日

设备管理科室意见：

同意


科室负责人签字：

  
2019年12月22日


财务科意见：

按相关规定执行。


科室负责人签字：

  
2020年3月2日

设备科分管院长意见：




签字：

  
2020年10月5日


财务科分管院长意见：

签字：

  
2020.3.8日

备注：

设备名称	钬激光	设备型号	3020
------	-----	------	------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用多年，已损坏。设备内无器件老化，咨询厂家回复维修金额16万+，维修后质保3个月。

该设备已达报废年限，维修成本高，建议报废！

使用风险高




签字：韦荣俊 晏亭 苏潘政

2023.7  
设备管理部


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：A2肛肠科

2019年12月11日

设备名称	微波治疗仪	购进日期	2014年
设备型号	WB-3200B	购进价格	15000
序列号	WB12C3608130961 <del>WB05D24061501441</del>	填报人	齐志敏
报废原因： <u>使用时间已到，不能正常工作，申请报废</u>		<div style="text-align: center;">             科室负责人签字：<u>齐志敏</u>            2019年12月11日         </div>	
设备管理科室意见： <u>同意</u>		<div style="text-align: center;">           科室负责人签字：<u>齐志敏</u>            2019年12月11日         </div>	
财务科意见： <u>报相关科室执行</u>		<div style="text-align: center;">             科室负责人签字：<u>罗</u>            2020年3月2日         </div>	
设备科分管院长意见： 		<div style="text-align: center;">           签字：<u>罗</u>            2020年3月4日         </div>	
财务科分管院长意见：		<div style="text-align: center;">           签字：<u>齐志敏</u>            2020.3.23 年 月 日         </div>	
备注：			

设备名称	微波治疗仪	设备型号	WB3200B
------	-------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：该设备主板损坏，通用设计使用寿命5年。









该设备已达报废年限，且维修成本高，建议报废。

签字：姜荣峰 姜章林  
姜正明


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：输血科

2019年12月12日

设备名称	灰色离心机	购进日期	2009.11
设备型号	ZB/BS	购进价格	1.6万
序列号		填报人	
报废原因：设备已不能正常使用。 科室负责人签字：  2019年12月12日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年1月28日			
财务科意见：  同意，报流程书办。 科室负责人签字：  2021年1月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	灰色离心机	设备型号	ZB/BS
------	-------	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：

~~该设备已损坏，故列为报废品。~~ 该设备  
使用年限长，维修成本风险高，建议报废。

签 字： 姜章林 潘成 靳

A12706

35

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：检验科 2019年12月17日

设备名称	生物安全柜	购进日期	2012.12.27
设备型号	BSC-1100II A2-X	购进价格	35000
序列号	无	填报人	刘明

报废原因：  
已坏

科室负责人签字：  
胡永红  
2019年12月17日

设备管理科室意见：  
同意

科室负责人签字：  
李进  
2020年1月7日

财务科意见：  
报有规定执行

科室负责人签字：  
罗兰  
2020年3月2日

设备科分管院长意见：  
同意


签字：  
2020年3月9日

财务科分管院长意见：  
同意

签字：  
胡明善  
2020.3.23

备注：

设备名称	生物安全柜	设备型号	BSC-1100 II A2-X
------	-------	------	------------------



设备维修（护）技术人员意见：主板损坏。

该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字：吴学书

魏波

2018.4.18

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：检验科 2019年12月17日

设备名称	<u>多标记时间分辨荧光免疫分析仪</u>	购进日期	<u>2014.8.26</u>
设备型号	<u>1420-020</u>	购进价格	<u>398300</u>
序列号	<u>4203716</u>	填报人	<u>刘世</u>
报废原因： <u>已坏</u> 科室负责人签字： <u>刘世</u> 2019年12月17日			
设备管理科室意见： <u>同意</u> 科室负责人签字： <u>李法新</u> 2020年1月7日			
财务科意见： <u>报相关科室执行</u> 科室负责人签字： <u>周学</u> 2020年3月2日			
设备科分管院长意见： 签字： <u>李法新</u> 2020年3月4日			
财务科分管院长意见： 签字： <u>刘月华</u> 2020.3.23			
备注：			

设备名称	多标记时间分辨荧光分析仪	设备型号	1420-020
------	--------------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：严重损坏

该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签

字：吴章林 潘明

魏的 森


10/10/2011  
10/10/2011


B0935  
37


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


申请科室： 检验科 2019年12月17日

设备名称	<u>低速离心机</u>	购进日期	<u>2009.11.25</u>
设备型号	<u>KDC-1044</u>	购进价格	<u>26800</u>
序列号	<u>020509000P2</u>	填报人	<u>刘华</u>

报废原因：  
已坏 科室负责人签字：刘华  
 2019年12月17日

设备管理科室意见：  
同意 科室负责人签字：李洪 李洪  
 2020年1月7日


财务科意见：  
根据相关规定执行 科室负责人签字：罗兴  
 2020年3月2日

设备科分管院长意见：  
 签字：李如平  
2020年3月4日

财务科分管院长意见：  
签字：古月 年月日  
2020.3.27

备注：

设备名称	低速离心机	设备型号	KDC-1044
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：主板损坏。

该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字：吴章书 2017.10.17

审核：[Signature]

156170


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

A17201


申请科室： 检验科 2019年12月17日

设备名称	UPS	购进日期	2012.12.27
设备型号	10KVA	购进价格	29000
序列号	120900061	填报人	王明


报废原因：  
已坏


科室负责人签字：  
  
2019年12月17日


设备管理科室意见：  
同意

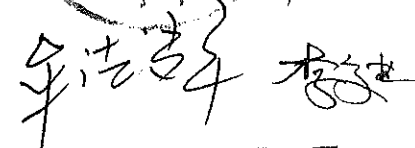科室负责人签字：  
  
2020年1月7日

财务科意见：  
报相关规范执行


科室负责人签字：  
  
2020年3月2日

设备科分管院长意见：  
签字：  
  
2020年3月4日

财务科分管院长意见：  
签字：  
  
年 月 日  
2020.3.23

备注：

设备名称	UPS	设备型号	
------	-----	------	--



设备维修（护）技术人员意见：*主板损坏*

该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字：*吴章芬 翁明*

*魏波 翁*





*1378 AD 000  
288 494*

39


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：检验科

2019年12月17日

设备名称	<u>血流动态分析仪</u>	购进日期	<u>2014.5.14</u>
设备型号	<u>PUC-2068B</u>	购进价格	<u>23,000</u>
序列号	<u>无</u>	填报人	<u>刘伟</u>
报废原因： <u>已坏</u>		科室负责人签字： <u>刘伟</u>	 2019年12月17日
设备管理科室意见： <u>同意</u>		科室负责人签字： <u>李进</u>	 2020年1月7日
财务科意见： <u>按相关规定执行</u>		科室负责人签字： <u>罗兴</u>	 2020年3月2日
设备科分管院长意见： <u>同意</u>		签字： <u>李进</u>	 2020年3月4日
财务科分管院长意见：		签字： <u>李进</u>	年月日 2020.3.23
备注：			

设备名称	血沉动态分析仪	设备型号	PUC-2068B
------	---------	------	-----------



设备维修（护）技术人员意见：主板损坏，

该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字：吴章书 姜朝  
 魏俊 燕

设备 A140713  
 设备 716

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

210

申请科室：耳鼻喉科


2019年12月20日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2009年5月
设备型号	MEC-1000	购进价格	28,000.00
序列号		填报人	黄自芸

报废原因：该设备达到报废使用年限，设备科维修组检查后建议报废。

科室负责人签字：李洪 2019年12月24日

设备管理科室意见：




科室负责人签字：李洪 2020年1月7日

财务科意见：

按相关规定执行。

科室负责人签字：罗兰 2020年3月2日

设备科分管院长意见：




签字：李洪 2020年3月4日

财务科分管院长意见：

签字：李洪 2020年3月23日

备注：

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，血压模块损坏，根据厂家提供资料显示，MEC-1000、MEC-2000整机配件已于2016年7月停产。该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字： 魏俊 吴章书  
 李 清洲








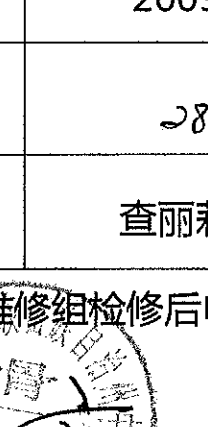

20926

44


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨二科

2019年12月23日

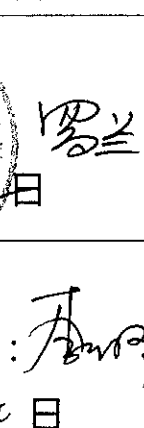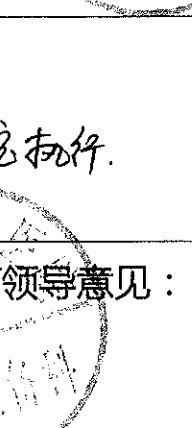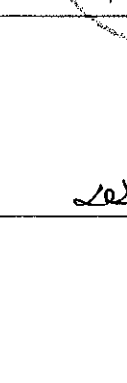设备名称	多参数监护仪	购进日期	2009
设备型号	MIL-1000 <del>U-400000-B</del>	购进价格	28,000.00
序列号	AD-96126387	填报人	查丽莉
报废原因：因使用年限过长不能正常使用，经维修组检修后申请报废。 科室负责人签字：  2019年12月23日 			
设备管理科室意见： 同意 科室负责人签字：  2020年1月7日 			
财务科意见： 据相关账目执行。 科室负责人签字：  2020年3月2日 			
职能管理科室分管领导意见： 签字：  2020年3月4日 			
总会计师意见： 财务分管院长 签字：  年月日 2020.3.23			
备注：			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

血压模块损坏 根据厂家提供资料 整机配件于2016年7月停产。  
 该设备已达报废年限，不能正常使用，建议报废。

签字：吴亭 潘正明

赖竹 章





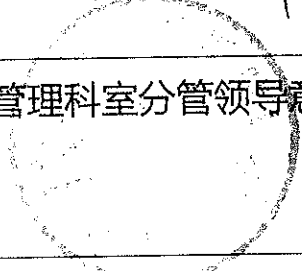


2016.8.10  
 2016.8.10

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


11/1071

申请科室：骨二科

2019年12月23日

设备名称	电脑骨伤愈合仪	购进日期	2013年4月 2015年6月
设备型号	ST-IIA	购进价格	45,000.00
序列号		填报人	查丽莉
<p>报废原因：因使用年限过长不能正常使用，经维修组检修后申请报废。</p> <p>科室负责人签字：</p> <p>2019年12月23日</p>			
<p>设备管理科室意见：  同意</p> <p>科室负责人签字：</p> <p>2020年1月9日</p>			
<p>财务科意见： 据相关规定执行</p> <p>科室负责人签字：</p> <p>2020年3月 日</p>			
<p>职能管理科室分管领导意见： </p> <p>签字：</p> <p>2020年3月4日</p>			
<p>总会计师意见： 财务分管院长</p> <p>签字：</p> <p>年月日 2020.3.23</p>			
备注：			

设备名称	电脑骨伤愈合仪	设备型号	
------	---------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：

该设备 ~~已达报废年限~~，不能正常使用，建议报废。

签

字：吴章书 为明

韩俊 东

111  
111  
111

114149

263


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨二科

2019年12月23日


设备名称	电脑骨伤愈合仪	购进日期	2013年4月
设备型号	ST-2H(22)	购进价格	45,000.5
序列号	HH-421506002	填报人	查丽莉

报废原因：因使用年限过长不能正常使用，经维修组检修后申请报废。


科室负责人签字：

2019年12月23日

设备管理科室意见：



同意

科室负责人签字：

2020年1月7日

财务科意见：


按相关规定执行

科室负责人签字：罗昱

2020年3月2日

职能管理科室分管领导意见：



签字：

2020年3月4日


总会计师意见：  
财务分管院长

签字：胡明

年月日 2020.3.23

备注：

设备名称	电脑骨伤愈合仪	设备型号	
------	---------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：

该设备 <sup>属于报废设备 外观损坏</sup> 已达报废年限，不能正常使用，建议报废。

签字：吴章书 姜正明  
 韩俊 张

010  
 015  
 A13021

A14245


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨二科

2019年12月23日

设备名称	肢关节功能恢复器	购进日期	2016.01
设备型号	JYD-C	购进价格	11,800.5
序列号	15086	填报人	查丽莉
报废原因：因使用年限过长不能正常使用，经维修组检修后申请报废。 科室负责人签字：[Signature] 2019年12月23日			
设备管理科室意见： [Signature] [Seal] 科室负责人签字：[Signature] 2020年1月7日			
财务科意见： 报账总账室执行 [Signature] 科室负责人签字：[Signature] 2020年3月2日			
职能管理科室分管领导意见： [Signature] [Seal] 签字：[Signature] 2020年3月4日			
总会计师意见： 财务分管院长 [Signature] 签字：[Signature] 年 月 日 2020.3.23			
备注：			

设备名称	肢关节功能恢复器	设备型号	
------	----------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：该设备属于损耗类设备，主机损坏。

该设备已达报废年限，不能正常使用，建议报废。

签字：吴章林 潘正剑

林俊 章

10月22日  
10月22日

B14236


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨二科


2019年12月23日

设备名称	肢关节功能恢复器	购进日期	2016.01
设备型号	JYD-C	购进价格	11.800.5
序列号	15088	填报人	查丽莉

报废原因：因使用年限过长不能正常使用，经维修组检修后申请报废。


科室负责人签字：

2019年12月23日



设备管理科室意见：



科室负责人签字：

2020年1月7日

财务科意见：

按相关规定执行。


科室负责人签字：

2020年3月2日




职能管理科室分管领导意见：



签字：

2020年3月4日


总会计师意见：  
财务分管院长

签字：

年月日 2020.3.23

备注：

设备名称	肢关节功能恢复器	设备型号	
------	----------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：

该设备 <sup>属于报修设备，主机电</sup> ~~已达报废年限~~，不能正常使用，建议报废。

签字：吴章林 潘正斌

李薇 蔡

2023.12.12

D14065

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：消毒供应室


2019年12月23日

设备名称	超声波清洗机	购进日期	2013年8月
设备型号	LK/CSJ-72L	购进价格	57900元
序列号	130652080 004	填报人	邹云

报废原因：超过使用年限，设备技术指标无法达到生产工艺要求，有安全隐患。

科室负责人签字：邹云  
2019年12月23日

设备管理科室意见：



科室负责人签字：李洪波  
2020年1月7日


财务科意见：

报相关规定执行



科室负责人签字：罗兰  
2020年3月1日

职能管理科室分管领导意见：



签字：[Signature]  
2020年3月4日


总会计师意见：  
对分管院长

[Signature]

签字：[Signature]  
2020.3.23  
年月日

备注：

设备名称	超声波清洗机	设备型号	LK/CSJ-72L
------	--------	------	------------



设备维修（护）技术人员意见：该设备属于报耗设备！电气部分不能通过改造达到新的技术指标要求  
~~该设备已达报废年限~~，不能正常使用，建议报废。  
 不能达到技术要求。

签字：吴章甘 翁明  
 魏的一 孙

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：眼科

2019年12月30日

设备名称	<u>视野弧度</u>	购进日期	<u>2009.01.</u>
设备型号	<u>YZ 22</u>	购进价格	<u>10.300.5</u>
序列号	<u>2201277</u>	填报人	

报废原因：

因设备不能正常使用。


科室负责人签字：

[Signature]

2019年12月30日

设备管理科室意见

同意



科室负责人签字：

[Signature]  
2020年1月7日

财务科意见：

报相关规定执行。

科室负责人签字：

[Signature]

2020年3月7日

设备科分管院长意见：



签字：

[Signature] 2020年3月4日

财务科分管院长意见：

签字：

[Signature]

年 月  
2020.3.23

日

备注：

设备名称	视野弧度检查仪	设备型号	
------	---------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：<sup>使用年限长，</sup>  
 该设备已损坏，维修<sup>价值</sup>~~成本~~高，建议报废。







签字： *李俊* *李俊*  
*李俊*

131:187


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：功能 I 科

2020 年 1 月 10 日

设备名称	彩色多普勒超声诊断仪	购进日期	2011.3.14
设备型号	SA8000	购进价格	124 万
序列号	B05506300003510	填报人	黄继红
报废原因：设备老化，图像衰减明显，成像质量差，不能满足检查需求，特申请报废。 科室负责人签字：黄继红  2020 年 1 月 10 日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：   2020 年 1 月 10 日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：罗兰 2021 年 1 月 3 日			
设备科分管院长意见： 签 字：  年 月 日			
总会计师意见： 签 字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签 字：  年 月 日			

设备名称	彩色多普勒超声诊断仪	设备型号	SA8000
------	------------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设备老化，使用年限长，图像衰减，成像质量差。  
~~该设备达到使用年限，~~不能满足临床使用要求，建议报废。

签字：韦荣收

吴章书 潘斌

B149

09


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室: 急诊医学科

2020年02月28日


设备名称	呼吸机	购进日期	2006.08.15
设备型号	HVJ-880A	购进价格	21600
序列号	500803090	填报人	张运良


报废原因: 使用年限已久, 各部件老化, 不能正常工作。

科室负责人签字: 

2020年2月28日

设备管理科室意见:




科室负责人签字: 

2020年2月28日


财务科意见:

同意

科室负责人签字: 


2020年4月10日

设备科分管院长意见:

签字: 

2020年2月28日


财务科分管院长意见:

签字: 

2020.4.16

备注:

设备名称	呼吸机	设备型号	HVJ-880A
------	-----	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，各部件老化严重，无法维修，该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字： 郭荣俊 吴翠芬  
 张 海斌








2016.4.21

(50)

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：口腔科

2020年03月12日

设备名称	牙科综合治疗机	购进日期	2012.07.26.
设备型号	ST-D307	购进价格	108,000.-
序列号	30712040822	填报人	蒙兴李
报废原因：该设备使用年限长，已无维修价值。 科室负责人签字：  2020年3月1日			
设备管理科室意见： 同意  科室负责人签字：  2020年4月9日			
财务科意见： 同意  科室负责人签字：  2020年4月10日			
设备科分管院长意见： 签字：  2020年4月15日			
财务科分管院长意见： 签字：  年月日 2020.4.06.			
备注：			

设备名称	牙科综合治疗机	设备型号	ST-D307
------	---------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：该设备外观损坏严重，多次维修，故障频繁，  
~~该设备已损坏，维修成本高，~~建议报废。

签字：韩俊 姜军书  
张 涛


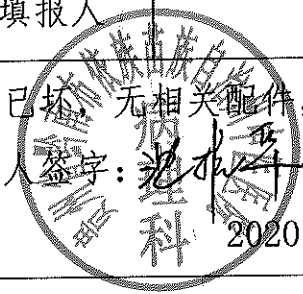








设备 446

(51)


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室： 病理科

2020年03月20日

设备名称	生物组织脱水机	购进日期	2006-8-15
设备型号	ZT-12P	购进价格	5.8万
序列号	无	填报人	沈振华
报废原因： 因设备使用年限已久，目前已坏，无相关配件，无维修价值。 科室负责人签字：   2020年3月20日			
设备管理科室意见：  同意。  科室负责人签字：  2020年4月9日			
财务科意见：  同意。  科室负责人签字：  2020年4月10日			
设备科分管院长意见： 签字：  2020年4月15日			
财务科分管院长意见： 签字：  年 月 日 2020.4.16			
备注：			

设备名称	生物组织脱水机	设备型号	ZT-12P
------	---------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

~~使用年限长，无配件，无法维修~~  
 该设备已损坏，~~维修成本高~~，建议报废。

签

字：









郭俊  
 吴章

设备26

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室: 肿瘤科

2020年 3月 30日

设备名称	心电图机	购进日期	2012.7.22
设备型号	MEC-1000	购进价格	23,600.5
序列号	AQ- <del>2118170</del> 2177954	填报人	
报废原因: 科室负责人签字:  2020年3月30日 			
设备管理科室意见:  同意 科室负责人签字:  2020年4月9日			
财务科意见:  同意 科室负责人签字:  2020年4月10日			
设备科分管院长意见: 签字:  2020年4月15日			
财务科分管院长意见: 签字:  年 月 日 2020.4.16			
备注:			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，血压模块损坏，根据厂家提供资料显示：MEC-1000、MEC-2000，整机配件已于2016年1月停产。  
~~该设备已损坏，维修成本高，~~ 建议报废。

签字： 魏俊  
 吴章 潘斌

136: 529

(3) B1008


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肺病内科

2020年04月02日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2010年07月05日
设备型号	MEC-1000	购进价格	25000.00元
序列号	AQ-02136206	填报人	李朝艳

报废原因：年久失修。



科室负责人签字：C 研


2020年04月02日

设备管理科室意见：


同意

科室负责人签字：陈明强

2020年4月9日



财务科意见：



科室负责人签字：罗兰

2020年4月10日

设备科分管院长意见：

签字：

李朝艳

2020年4月15日

财务科分管院长意见：

签字：


古明培

年月日

2020.4.16

备注：

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，血压模块损坏，根据厂家提供的资料显示：MEC-1000、MEC-2000 整机及配件已于2016年10月停产。  
~~该设备已损坏，维修成本高，~~建议报废。

签字：  
 魏俊 姜宇  
 潘琳 苏

2018.10.24

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肺病内科


2020年04月02日

设备名称	多参数监护仪	购进日期	2013年04月
设备型号	MEC-1000	购进价格	23600.00元
序列号	AQ-22166918	填报人	李朝艳

报废原因：年久失修。

科室负责人签字：(李朝艳)


2020年04月02日



设备管理科室意见：同意。

科室负责人签字：(李朝艳)


2020年4月9日



财务科意见：同意。

科室负责人签字：(李朝艳)

2020年4月10日



设备科分管院长意见：

签字：(李朝艳)

2020年4月15日


财务科分管院长意见：

签字：(胡朝艳)

年月日  
2021.4.16

备注：

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，高位模块损坏，根据厂家提供的资料显示：MEC-1000、MEC-2000整机配件已于2016年7月停产，该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字： 魏荣俊 吴宇峰  
潘斌 苏




2016.11.23

15 B1007


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肺病内科

2020年04月02日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2010年07月05日
设备型号	MEC-1000	购进价格	25000.00元
序列号	AQ-22166524	填报人	李朝艳
报废原因：年久失修。  科室负责人签字：C 刘 2020年04月02日			
设备管理科室意见： 同意。  科室负责人签字：刘明 2020年4月9日			
财务科意见：  科室负责人签字：罗兰 2020年4月10日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 2020年4月5日			
财务科分管院长意见： 签字：胡少军 年月日 2020.4.16			
备注：			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，血压模块坏，根据厂家提供资料显示，MEC-1000 MEC-2000，整机配件已于2016年8月停产  
~~该设备已损坏，维修成本高，~~ 建议报废。

签字：  
 魏定 吴章  
 潘斌 苏

2016年7月20日






356 B0907

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


申请科室：骨伤一科

2020年 4月 23日



157

设备名称	心电监护仪	购进日期	2009.3.27
设备型号	MEC-1000	购进价格	28000元
序列号	AQ-91120963	填报人	刘婷婷
报废原因：使用年限长，图像不显示 科室负责人签字：  2020年4月23日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年6月8日			
财务科意见： 科室负责人签字：  2020年6月9日			
设备科分管院长意见： 签字：  2020年6月9日			
财务科分管院长意见： 签字：  2020年6月9日			
备注：			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：该设备使用年限长，高压模块损坏，根据厂家提供资料显示 MEC-1000、MEC-2000 整机配件已于2016年停产，  
~~该设备已损坏，维修成本高，~~ 建议报废。

签字：韦荣俊   
 吴章林 

2016.12.28

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


63

申请科室：脑病外科

2020年6月24日



设备名称	<u>心电监护</u>	购进日期	<u>2007年4月</u>
设备型号	<u>PM-7000</u>	购进价格	<u>39000.</u>
序列号	<u>CE72-0265</u>	填报人	<u>王浩</u>
报废原因： <u>使用时间过长，无法修复。</u> 科室负责人签字： <u>[Signature]</u> 2020年 <u>6</u> 月 <u>24</u> 日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字： <u>[Signature]</u> 2020年 <u>6</u> 月 <u>8</u> 日			
财务科意见： 科室负责人签字： <u>[Signature]</u> 2020年 <u>6</u> 月 <u>9</u> 日			
设备科分管院长意见： 签字： <u>[Signature]</u> 2020年 <u>6</u> 月 <u>9</u> 日			
财务科分管院长意见： 签字： <u>[Signature]</u> 2020年 <u>6</u> 月 <u>9</u> 日			
备注：			

设备名称	心电监护仪	设备型号	PM-7000
------	-------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备相关配件因厂家停产无法提供  
~~该设备已损坏，维修成本高~~，建议报废。

签字：   


注：直可：63

58

637

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室： 手术麻醉科

2020年4月27日

设备名称	高频电刀	购进日期	2013年
设备型号	DGD-300B-2	购进价格	2800元
序列号	BN12736	填报人	陈英碧

报废原因：使用年限长，漏电电流大，存在安全隐患，无维修价值，申请报废。

科室负责人签字： [Signature] 2020年4月27日

设备管理科室意见：

科室负责人签字： [Signature] 2020年6月8日

财务科意见：

科室负责人签字： [Signature] 2020年6月9日

设备科分管院长意见：


签字： [Signature] 2020年6月9日

财务科分管院长意见：

签字： [Signature] 2020年6月9日

备注：

设备名称	高频电刀	设备型号	DGD-300B-2
------	------	------	------------



设备维修（护）技术人员意见：该设备设计使用年限为4年。

该设备已达到使用年限，漏电电流大，存在安全隐患，维修价值不大，建议报废。

签字： 魏俊 靳  
吴章书 连科




设备清单

5


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：超声、功能检查科

2020年6月5日

设备名称	彩色B超	购进日期	2006.08
设备型号	飞凡影像先进型	购进价格	176万
序列号	USN0405173	填报人	黄继红
报废原因：该设备已使用 15 年，设备老化，超声图像质量极差，已不能适应工作要求，特申请报废。 科室负责人签字：黄继红  2020年6月5日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature]  2020年6月5日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	彩色多普勒超声诊断仪	设备型号	M2540A
------	------------	------	--------







设备维修(护)技术人员意见: 设备老化, 使用年限长, 图像衰减, 成像质量差, ~~该设备达到使用年限~~, 不能满足临床使用要求, 建议报废。

签字: 韩俊 李  
吴宇 潘斌

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2012.5.22
设备型号	XJZB-I	购进价格	47000
序列号	A12194	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：  2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年6月28日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命.5年.








该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签 字： 韩俊 潘明  
吴章林 张


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2012.5.22
设备型号	XJZB-I	购进价格	45000
序列号	A1218	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：  2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年6月28日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签 字：  年 月 日			
总会计师意见： 签 字：  年 月 日			
院长意见： 签 字：  年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	ST-IH
------	-----	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签

字：








张敏

吴宇林


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2014.01.28
设备型号	XJZB-I	购进价格	47000
序列号	A14010	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：  2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年6月28日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。



签字： 魏俊涛  
吴章林

B


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2013.12.16
设备型号	XJZB-I	购进价格	47000
序列号	A13111	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：  2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年6月28日			
财务科意见：  同意，按流程报批。 科室负责人签字：  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。


该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签字：韩波、潘斌  
姜书一


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2014.03.12
设备型号	XJZB-I	购进价格	47000
序列号	A14012	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
财务科意见：  同意 按流程办理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签字： 韩俊 姜斌  
吴章 姜


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2014.11.12
设备型号	XJZC	购进价格	47000
序列号	A13080	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Handwritten Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Handwritten Signature] 2020年6月28日			
财务科意见： 同意，按流程办理。 科室负责人签字：[Handwritten Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Handwritten Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Handwritten Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Handwritten Signature] 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZC-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。








该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签字：韩俊涛  
吴景林


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2015.03.27
设备型号	XJZC-II	购进价格	47000
序列号	A14134	填报人	刘婷婷
<p>报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>财务科意见：  同意按流程办理。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2021年9月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZC-II
------	-----	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。








该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签 字：韩俊 刘  
吴章 孙


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2015.03.27
设备型号	XJZC-II	购进价格	47000
序列号	A14135	填报人	刘婷婷
<p>报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>财务科意见：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>同意 报流程办</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>科室负责人签字：  2021年8月3日</p> </div> </div>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZC-II
------	-----	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：*设计使用寿命5年。*








该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签 字：*韩俊涛*  
*吴章林*

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2015.02.05
设备型号	XJZC-II	购进价格	47000
序列号	A14088	填报人	刘婷婷
<p>报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2021年9月3日</p> <p style="text-align: center;"> 同意，按流程办理。</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZC-II
------	-----	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签字：韩俊斌  
吴章林

67


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2015.02.05
设备型号	XJZC-II	购进价格	47000
序列号	A14087	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
财务科意见： 同意，按流程处理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZ-11
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：*该设备使用年限过长*

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签 字：*韩的、潘斌*  
*吴章林*


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2015.01.07
设备型号	XJZC-II	购进价格	47000
序列号	A14086	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
财务科意见： 同意，按流程处理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-II
------	-----	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签字：蔡正  
蔡正

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2013.04.18
设备型号	XJZB-I	购进价格	47000
序列号	A13019	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
财务科意见： 同意报废流程处理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签 字： 魏俊涛  
 魏俊涛

72


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	智能型中药熏蒸汽自控 治疗仪	购进日期	2013.04.18
设备型号	XJZB-I	购进价格	47000
序列号	A13020	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
财务科意见： 同意，报流程处理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	XJZB-I
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：设计使用寿命5年。

该设备已损坏且达到使用年限，无法修复，建议报废。

签字： 魏敏 魏敏  
吴章林 魏敏


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤一科

2020年6月28日

设备名称	手术显微镜	购进日期	2006.08.15
设备型号	XTS-4A	购进价格	15000
序列号	B167	填报人	刘婷婷
报废原因：因设备长时间使用后已不能修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年6月28日			
财务科意见： 同意报废流程书观。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	手术显微镜	设备型号	XTS-4A
------	-------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签 字：

韩俊涛  
吴军

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：重症医学科

2020年6月30日

设备名称	血气分析仪	购进日期	2012年
设备型号	OPTI CCA-TS	购进价格	10万
序列号		填报人	法译
报废原因：损坏，无法正常使用。 科室负责人签字：何志 2020年6月30日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：何志 2020年6月30日			
财务科意见： 同意，按流程办理 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李亚平 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李亚平 年 月 日			

设备名称	血气分析仪	设备型号	OPTI CCA-TS
------	-------	------	-------------



设备维修（护）技术人员意见：






该设备使用年限长，元器件老化，建议报废。

签 字： 韩俊


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：重症医学科

2020年6月30日

设备名称	五功能电动床	购进日期	2012年
设备型号	KS-838	购进价格	3.5万
序列号		填报人	陆洋
报废原因：损坏，无法正常使用。		科室负责人签字：	 2020年6月30日
设备管理科室意见：		科室负责人签字：	 2020年6月30日
财务科意见：  同意 报流程书 现		科室负责人签字：	罗兰 2021年9月3日
设备科分管院长意见：		签字：	 年 月 日
总会计师意见：		签字：	徐志庆 年 月 日
院长意见：		签字：	 年 月 日

设备名称	五功能电动床	设备型号	KS-838
------	--------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：





该设备使用年限长，床板、支撑臂变形，建议报废。

签 字： 韩俊一


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肾病科


2020年7月01日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2008.06.23
设备型号	MEC-1000	购进价格	29000
序列号	AQ-77102125	填报人	李强
报废原因：已损坏，不能修复。		科室负责人签字：	 2020年7月1日
设备管理科室意见：		科室负责人签字：	 2020年7月1日
财务科意见：		同意，按流程办理	科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日
设备科分管院长意见：		签字：	 年 月 日
总会计师意见：		签字：	徐志庆 年 月 日
院长意见：		签字：	 年 月 日

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------









设备维修（护）技术人员意见：根据厂家提供资料显示 MEC-1000 整机及配件已于2016年7月停产  
 该设备已损坏，该设备厂家已停产无配件维修，建议报废。

签字： 鞠俊   
 吴章林 潘斌

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表


申请科室：麻醉手术科

2020年7月02日

设备名称	腹腔镜器械	购进日期	2012.29, 2013.10.31
设备型号	美国史赛克	购进价格	27.6万、42.774万
序列号	A1201	填报人	陈尧鸣
报废原因：设备故障，已无法正常使用，已无法修复。 科室负责人签字：  2020年7月2日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年7月2日			
财务科意见： 科室负责人签字：  2021年7月3日			
设备科分管院长意见： 签 字：  年 月 日			
总会计师意见： 签 字：  年 月 日			
院长意见： 签 字：  年 月 日			

7

设备名称	腹腔镜器械	设备型号	
------	-------	------	--



设备维修（护）技术人员意见：该批器械属于损耗类。

该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签字： 魏东 魏东  
吴章林 魏东


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2020年7月02日

设备名称	灌注泵（腹腔镜）	购进日期	2013.01.31
设备型号	T.5450	购进价格	21万
序列号	A13006	填报人	张世明
报废原因：设备故障，已无法正常使用，已无法修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年7月2日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年7月2日			
财务科意见： 同意 按流程办理 [Signature] 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	灌注泵	设备型号	T5450
------	-----	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：*该设备属于损耗类设备*。

该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。







签字：*韩俊清*  
*吴辛*

79


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肺病内科

2020年7月02日

设备名称	多参数监护仪	购进日期	2012.05.22
设备型号	PM-7000	购进价格	25000
序列号		填报人	李经国
报废原因：年久失修。		科室负责人签字：	 [Signature] 2020年7月2日
设备管理科室意见：		科室负责人签字：	 [Signature] 2020年7月2日
财务科意见：		科室负责人签字：	 [Signature] 2021年9月3日
设备科分管院长意见：		签字：	 年 月 日
总会计师意见：		签字：	 年 月 日
院长意见：		签字：	 年 月 日

设备名称	多参数心电监护仪	设备型号	PM-7000
------	----------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：屏幕高压模块损坏。

该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签字：韩伟  
吴章林

8

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2020年7月02日

设备名称	等离子电切系统	购进日期	2012.12.26
设备型号	AUTOCOCN@II400	购进价格	25000
序列号	A12196	填报人	陈芳
报废原因：设备故障，已无法正常使用，已无法修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年7月2日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年7月2日			
财务科意见： 同意，报废流程机 [Signature] 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	等离子电切系统	设备型号	AUTOCON@II400
------	---------	------	---------------



设备维修(护)技术人员意见: 元器件老化.

该设备已损坏, 维修成本高, 使用年限长, 建议报废。

签字: 韩俊涛  
吴章

81-82.


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2020年7月03日

设备名称	麻醉咽喉镜	购进日期	2018.05.31
设备型号	MJ-IIB	购进价格	1200X2
序列号	A14698 A14694	填报人	高志秀
报废原因：麻醉咽喉镜已坏，无法维修，申请报废。 科室负责人签字：[Signature] 2020年7月03日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年7月3日			
财务科意见： 同意，按流程办理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	麻醉咽喉镜	设备型号	A14698\A14694
------	-------	------	---------------



设备维修（护）技术人员意见：封装设备。


该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字： 韩荣俊 潘明  
吴章林 李


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2020年07月03日

设备名称	便携式吸引器	购进日期	2018.05.31
设备型号	5X820D	购进价格	1200
序列号	A14693	填报人	高志庆
报废原因：吸引器损坏，无法修复，申请报废。 科室负责人签字：程斌 2020年07月03日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：陆晓斌 2020年7月3日			
财务科意见：  同意报废 科室负责人签字：冯兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李正卿 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李正卿 年 月 日			

设备名称	便携式吸引器	设备型号	5X820D
------	--------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：核心部件压力泵损坏。







该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签字：韩俊 潘斌  
姜军 孙


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：急诊科

2020年7月24日

设备名称	十二道心电图机	购进日期	2012.11.19
设备型号	CM1200B	购进价格	24000
序列号	A12176	填报人	张运良
<p>报废原因：因年限已久不能正常使用，经设备科检修后建议报废。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年7月24日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年7月24日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: center;">同意，按流程办理。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2021年9月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			

设备名称	十二道心电图机	设备型号	CM1200B
------	---------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：*该设备元器件老化，图形输出效果差。*

该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签字：*韩俊琦*  
*吴章林*

85-86

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤科（创伤病区）

2020年7月29日

设备名称	熏蒸机（2台）	购进日期	2016
设备型号	HB1000	购进价格	35000X2
序列号	(151222110) (151222119)	填报人	李淑
报废原因：因使用年限过长经多次维修后已不能正常工作，特申请报废。 科室负责人签字：李淑 年 月 日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：李淑 2020年7月29日			
财务科意见： 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日 同意报废流程书办			
设备科分管院长意见： 签 字：李淑 年 月 日			
总会计师意见： 签 字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签 字：李淑 年 月 日			

设备名称	熏蒸机	设备型号	BH1000
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：该设备属于损耗类设备。





该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签字：韩俊 潘  
吴 菲


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：急诊医学科

2020年8月24日

设备名称	床单位消毒机	购进日期	2013.05.28
设备型号	LK/CXD	购进价格	13900
序列号	A13040	填报人	张运良
<p>报废原因：因使用年限过长已不能正常使用，经设备科检修后建议报废。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年8月24日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年8月24日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: right;">同意，按流程处理。 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签字：徐志庆 年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			

设备名称	床单位消毒机	设备型号	LK\CXD
------	--------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

臭氧发生器损坏，维修成本高。








该设备已损坏，~~无法修复~~，建议报废。

签字： 韦荣俊 潘斌  
吴章林 李

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肝胆外科

2020年9月11日

设备名称	呼吸机	购进日期	2008.06
设备型号	HVJ-880A	购进价格	38000
序列号	(20)0803032	填报人	
<p>报废原因：年限过久，无法正常使用。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字： 2020年9月11日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字： 2020年9月11日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: right;">同意按流程办理。 科室负责人签字： 2021年9月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			

设备名称	肝胆外科	设备型号	HVJ-880A
------	------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：*各部件老化。*

该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。

签 字：*韩少斌*  
*吴景书*


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2020年9月17日

设备名称	婴儿培养箱	购进日期	2006.08.15
设备型号	YP-90A	购进价格	21300
序列号	06070802008	填报人	高志华
报废原因：已达到使用年限，箱内温度与设置温度不符。 科室负责人签字：[Signature] 2020年09月17日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年9月17日			
财务科意见： 同意，按流程办理。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	婴儿培养箱	设备型号	YP-90A
------	-------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，使用年限长，成本风险高，建议报废。

签字： 韦荣俊 潘  
吴 翰 森


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2020年11月04日

设备名称	妇科子宫切除术	购进日期	2007.09.15
设备型号	DZ-1	购进价格	4万
序列号	B0716	填报人	陈艺彤
报废原因：设备故障，已无法正常使用，已无法修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年11月4日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年11月4日			
财务科意见： 同意报废程序。 [Stamp] 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	妇科子宫切除 机	设备型号	DZ-1
------	-------------	------	------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。

签 字： 魏俊 潘斌  
吴章林 李


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2020年11月04日

设备名称	胆道镜	购进日期	2009.01.19
设备型号	CHF-P20	购进价格	23.5万
序列号	A0901	填报人	张永平
报废原因：设备故障，已无法正常使用，已无法修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年11月4日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年11月4日			
财务科意见： 同意，按流程处理。科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	胆道镜	设备型号	A0901
------	-----	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：









该设备已损坏，无法修复，使用年限长，建议报废。

签 字： 韦 蔡 俊 潘 斌  
 吴 章 赫 李 斌


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2020年11月05日

设备名称	关节镜	购进日期	2017.09.15
设备型号	30°	购进价格	6.7万
序列号	A14403	填报人	
<p>报废原因：设备故障，已无法正常使用，已无法修复。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年11月5日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年11月5日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: center;"> 同意 报流程办</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2021年9月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			

设备名称	关节镜	设备型号	30°
------	-----	------	-----



设备维修（护）技术人员意见：属于损耗类。

该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签字： 魏俊 潘斌  
吴章林

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2020年12月01日

设备名称	床单位消毒机	购进日期	2013.05.28
设备型号	LK/CXD	购进价格	13900
序列号		填报人	高才学
报废原因：设备坏，无法修复。 科室负责人签字：[Signature] 2020年12月01日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年12月1日			
财务科意见： 同意，报废程序正确。 科室负责人签字：[Signature] 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	床单位消毒机	设备型号	LK\CXD
------	--------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

臭氧发生器损坏。

该设备已损坏，维修成本高，建议报废。

签








字：

韩俊 潘斌  
吴章书 李

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肾病科

2020年12月15日

设备名称	结肠透析机	购进日期	2015.07.23
设备型号	JCJ-I	购进价格	135000
序列号	JH150603	填报人	梁碧华
报废原因：该设备损坏，不能正常使用，经询问厂家维修，维修费过高，故申请报废。 科室负责人签字：  2020年12月15日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年12月15日			
财务科意见：  同意，按流程办。 科室负责人签字：  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	结肠透析机	设备型号	JCJ-I
------	-------	------	-------



设备维修（护）技术人员意见：


该设备已损坏，<sup>为主板故障。</sup>维修成本高，建议报废。

签字： 魏俊涛  
吴翰章


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：骨伤脊柱关节病区

2020年12月08日

设备名称	超声骨密度仪	购进日期	2010.07.05
设备型号	OsteoProUBD2002A	购进价格	14.8万
序列号	TCPQC-1005-03-S10123	填报人	李
报废原因：长期使用后设备已无法修复。 科室负责人签字：李 2020年12月8日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：李 年 月 日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：罗 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签 字：李 年 月 日			
总会计师意见： 签 字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签 字：李 年 月 日			

设备名称	超声骨密度仪	设备型号	OeteoPRO UBD2002A
------	--------	------	-------------------



设备维修（护）技术人员意见：


该设备使用年限长，<sup>元器件老化</sup>现已损坏，属于放射类设备，建议报废。

签字： 李荣俊 潘成  
吴章林 李


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：心病内科

2020年12月24日

设备名称	除颤仪	购进日期	2009.07
设备型号	M4735A	购进价格	10.8万
序列号	US00573170	填报人	18年2月
报废原因：不能维修使用。 科室负责人签字：[Signature] 2020年12月24日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2020年12月24日			
财务科意见：  同意，报流能书观。 科室负责人签字：[Signature] 2021年1月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	除颤仪	设备型号	M4735A
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：



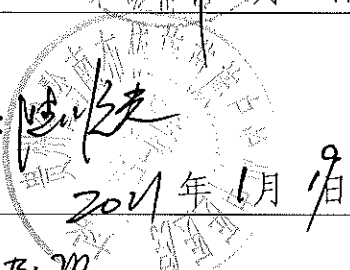

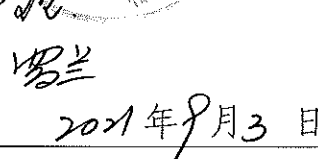



该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。

签 字： 魏俊 海川  
吴宇 曹 东

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：产科

2021年01月19日

设备名称	胎儿多参数监护仪	购进日期	2015.06.10
设备型号	STAR5000E	购进价格	1.88万
序列号	5520106034	填报人	杨光北
报废原因：厂家回复维修价值不高，申请报废。 科室负责人签字：		 年 月 日	
设备管理科室意见：		科室负责人签字：	
		 2021年1月9日	
财务科意见：		同意，报流程审批 科室负责人签字：	
		 2021年1月3日	
设备科分管院长意见：		签字：	
		 年 月 日	
总会计师意见：		签字：	
		 年 月 日	
院长意见：		签字：	
		 年 月 日	

设备名称	胎儿多参数监护仪	设备型号	STAR5000E
------	----------	------	-----------



设备维修（护）技术人员意见：厂家回复维修价值不高。

该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。

签字： 郝俊新  
吴章林

98

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2021年02月24日

设备名称	麻醉机	购进日期	2013.01.21
设备型号	Aeon7200	购进价格	21.5万
序列号	A13001	填报人	陈廷华
报废原因：使用年限久，已无法修复，已无法正常工作。 科室负责人签字：[Signature] 2021年2月24日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：[Signature] 2021年2月24日			
财务科意见： 科室负责人签字：[Signature] 2021年2月3日			
设备科分管院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：[Signature] 年 月 日			

设备名称	麻醉机	设备型号	Aeon7200
------	-----	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：*元器件老化。*







该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。

签 字：*魏俊·潘斌*  
*吴章伟*

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：麻醉手术科

2021年02月24日

设备名称	麻醉机	购进日期	2009.08.28
设备型号	ZY9100	购进价格	17万
序列号	A0908	填报人	陈世以
报废原因：使用年限久，已无法修复，已无法正常工作。 科室负责人签字：  2021年2月24日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2021年2月24日			
财务科意见：  同意，按流程办理。 科室负责人签字：罗兰 2021年2月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	麻醉机	设备型号	ZY9100
------	-----	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：*元器件老化。*




该设备已损坏，维修成本高，使用年限长，建议报废。

签字：*魏爱华 潘斌*  
*吴章林 李*

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：眼耳鼻喉科

2021年03月02日

设备名称	心电监护仪	购进日期	
设备型号	MEC-1000	购进价格	2.8万
序列号	AQ-94124044	填报人	杨
<p>报废原因：该设备无法正常使用。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：贺兴    2021年3月2日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：陆川    2021年3月2日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: right;">同意，按流程办理。  科室负责人签字：罗兰    2021年3月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：李亚明  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：徐志庆  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：李亚明  年 月 日</p>			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：厂家提供资料显示整机配件已于2016年7月  
停产。

该设备已损坏，故障为显示屏高压模块损坏，该设备使用年限长，维修成本风险高，建议报废。

签








字：

韩海斌  
姜萍


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：脊柱关节病区

2021年03月09日

设备名称	多参数心电监护仪	购进日期	2021.08.31
设备型号	UT4000B	购进价格	4.5万
序列号	CN4BBAJR00367	填报人	
<p>报废原因：因使用年限过长，现无法维修。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2020年6月28日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：  2021年9月3日</p> <p style="text-align: left;"> 同意，按流程办理。</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签 字：  年 月 日</p>			

设备名称	多参数心电监护仪	设备型号	UT4000B
------	----------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备不能测量心电且使用年限长，故障风险高，建议报废。

签




字：

魏俊 姜楠

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：肛肠科

2021年06月15日

设备名称	肛肠多功能检查治疗仪	购进日期	2012.11.19
设备型号	XN-X	购进价格	9万
序列号	XNG22W1207138	填报人	刘子凡
报废原因：设备反复修理不能正常使用。 科室负责人签字：符毅平  2021年6月15日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：李如强  2021年6月15日			
财务科意见： 同意，按流程处理。  科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李如强 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李如强 年 月 日			

设备名称	肛肠多功能检查治疗仪	设备型号	XN-X
------	------------	------	------



设备维修（护）技术人员意见：使用年限长，各部件老化。









该设备已损坏，无法修复，建议报废。

签字： 韩俊涛  
吴章

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：脾胃肝胆内科

2021年06月23日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2012.12.27
设备型号	MEC-1000	购进价格	2.36万
序列号	AQ-14152978	填报人	
报废原因：厂家配件已停产，无法修复。 科室负责人签字：  2021年6月23日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2021年6月23日			
财务科意见：  同意 按流程报批。 科室负责人签字：  2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  年 月 日			
总会计师意见： 签字：  年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备血压模块已损坏，厂家配件已停产，使用年限长，无法修复建议报废。

签









字：

韩俊  
 吴章伟


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：脾胃肝胆内科

2021年06月23日

设备名称	心电监护仪	购进日期	2012.12.27
设备型号	MEC-1000	购进价格	2.36万
序列号	AQ-1B162310	填报人	
<p>报废原因：厂家配件已停产，无法修复。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字： 2021年6月23日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字： 2021年6月23日</p>			
<p>财务科意见：  同意，按流程处理。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字： 2021年6月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字： 年 月 日</p>			

设备名称	心电监护仪	设备型号	MEC-1000
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备血压模块已损坏，厂家配件已停产，使用年限长，无法修复建议报废。

签







字：

105


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：脊柱、关节病区

2021年06月30日

设备名称	多参数心电监护仪	购进日期	2002.04.21
设备型号	PM-7000	购进价格	3.9万
序列号	CE72-0244	填报人	
报废原因：使用年限过长无法修复。 科室负责人签字：  2020年6月30日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  2020年6月30日			
财务科意见：  同意 报流程处理 科室负责人签字： 罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签 字：  年 月 日			
总会计师意见： 签 字：  年 月 日			
院长意见： 签 字：  年 月 日			

设备名称	多参数心电监护仪	设备型号	PM-7000
------	----------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：








该设备已损坏且使用年限长，厂家配件已停产，无法修复，建议报废。

签字： 姜学东  
姜学东


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：医学影像科

2021年07月08日

设备名称	移动式数字医用 X 线机	购进日期	2015.06.30
设备型号	MobileSparkler	购进价格	158 万
序列号	110100001-1505002-001	填报人	
报废原因：设备损坏，维修成本高，申请报废。		科室负责人签字：  2021年7月8日	
设备管理科室意见：		科室负责人签字：  2021年7月8日	
财务科意见：		同意，按流程办理。 科室负责人签字：  2021年9月3日	
设备科分管院长意见：		签 字：  年 月 日	
总会计师意见：		签 字：  年 月 日	
院长意见：		签 字：  年 月 日	

设备名称	移动式数字医用 X 线机	设备型号	MobileSparkler
------	--------------	------	----------------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已损坏，维修成本高(数据采集板 18 万、电池 8 万)，建议报废。

签







字：

韩伟、潘峰  
吴平、李

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：输血科

2021年07月08日

设备名称	低温保存箱	购进日期	2008.12.22
设备型号	DW-40L188	购进价格	1.6万
序列号	BE06L001T00B286H7WGQ	填报人	
报废原因：使用年限长，经维修后不能正常使用。 科室负责人签字：  2021年07月08日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：  年 月 日			
财务科意见：  同意，报流程审批。 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：  2021年 月 日			
总会计师意见： 请统一报国资局审批。 字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：  年 月 日			

设备名称	低温保存箱	设备型号	DW-40L188
------	-------	------	-----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备属于存血专用设备，已损坏，考虑该设备使用 13 年，元器件老化，故障风险高，建议报废。

签 字：

208

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：呼吸与重症医学科

2021年07月08日

设备名称	电动吸引器	购进日期	2018.07.16
设备型号	YB-DX23B	购进价格	4000元
序列号	17N2.013	填报人	李红印
报废原因：该设备电机烧毁，使用寿命三年，申请报废。 科室负责人签字：李红印 2021年07月08日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：李红印 年 月 日			
财务科意见： 同意，按流程办理。 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李红印 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李红印 年 月 日			

设备名称	电动吸引器	设备型号	YB-DX23B
------	-------	------	----------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备电机烧毁，说明书标注使用寿命三年，建议报废。

签 字： 魏敏、吴章林、  
潘改群。

# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2021年07月08日

设备名称	婴儿培养箱	购进日期	2009.11.13
设备型号	YP-100A	购进价格	2.6万
序列号	02090302010	填报人	陈
报废原因：该设备使用时间长，故障频发，申请报废。 科室负责人签字：陈 2021年07月08日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：李 2021年7月8日			
财务科意见：财 科室负责人签字：罗 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李 年 月 日			

设备名称	婴儿培养箱	设备型号	YP-100A
------	-------	------	---------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已使用 11 年，元器件老化，故障风险高，建议报废。

签 字：

李静收


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2021年07月08日

设备名称	新生儿黄疸治疗仪	购进日期	2014.06.06
设备型号	XHZ-90	购进价格	3万
序列号	42140305016	填报人	高伟
<p>报废原因：该设备使用时间长，故障频发，申请报废。</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：高伟 2021年07月08日</p>			
<p>设备管理科室意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：何川送 2021年7月8日</p>			
<p>财务科意见：</p> <p style="text-align: right;">科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日</p>			
<p>设备科分管院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字：李强 年 月 日</p>			
<p>总会计师意见：</p> <p style="text-align: right;">签字：徐志庆 年 月 日</p>			
<p>院长意见：</p> <p style="text-align: right;">签字：李强 年 月 日</p>			

设备名称	新生儿黄疸治疗仪	设备型号	XHZ-90
------	----------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已使用 7 年 ， 元器件老化，故障风险高，建议报废。

签 字： 李某某


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2021年07月08日

设备名称	CPAP 持续气道正压通气系统	购进日期	2014.05.22
设备型号	AD-II	购进价格	6.5万
序列号	13096 II 026	填报人	李志强
报废原因：该设备使用时间长，故障频发，申请报废。 科室负责人签字：李志强 2021年07月08日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：李志强 2021年7月8日			
财务科意见： 同意 按流程办理。 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：李志强 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：李志强 年 月 日			

设备名称	CPAP 持续气道正压 通气系统	设备型号	AD- II
------	---------------------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已使用 7 年 ， 元器件老化，故障风险高，建议报废。

签 字：

李荣波


# 黔南州城市公立医院物资设备报废申请表

申请科室：儿科

2021年07月08日

设备名称	CPAP 持续气道正压通气系统	购进日期	2014.05.22
设备型号	AD- II	购进价格	6.5 万
序列号	13096 II 010	填报人	高志庆
报废原因：该设备使用时间长，故障频发，申请报废。 科室负责人签字：高志庆 2021年07月08日			
设备管理科室意见： 科室负责人签字：高志庆 2021年7月8日			
财务科意见： 同意，按流程办理。 科室负责人签字：罗兰 2021年9月3日			
设备科分管院长意见： 签字：高志庆 年 月 日			
总会计师意见： 签字：徐志庆 年 月 日			
院长意见： 签字：高志庆 年 月 日			

设备名称	CPAP 持续气道正压 通气系统	设备型号	AD- II
------	---------------------	------	--------



设备维修（护）技术人员意见：

该设备已使用 7 年 ， 元器件老化，故障风险高，建议报废。

签 字： 韩总